

ALCOTEST Dräger 9510

KARTA PRODUKTU

Dräger Alcotest 9510 jest przedstawicielem nowej generacji sprzętu do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu zaprojektowanym z myślą o zgodności z większością przepisów międzynarodowych dotyczących takich urządzeń. Technologia pomiarowa została ulepszona przez użycie nowego sensora spektrofotometrycznego o wyższej gęstości energii umożliwiającego uzyskanie jeszcze bardziej precyzyjnych wyników.

PRODUCENT

Dräger



Dräger Alcotest 9510 można dodatkowo wyposażać w sprawdzony, elektrochemiczny system pomiarowy Dräger ze specyficznością wobec alkoholu. W takiej konfiguracji koncepcja "podwójnego sensora" zwiększa sądową dopuszczalność wyników. Zaawansowany czujnik podczerwieni niewrażliwy na zawarte w oddechu badanego substancje mogące potencjalnie zakłócać pomiary bazuje na metodzie fizycznej, a czujnik elektrochemiczny wykorzystuje do celów analizy reakcje chemiczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu alkomat ten spełnia wszelkie kryteria urządzenia dowodowego.

Długi, elastyczny i podgrzewany wąż eliminuje kondensację i zapewnia wygodę zarówno osobie badanej, jak i obsługującej urządzenie. Jednorazowy ustnik gwarantuje higieniczny kontakt osoby badanej z urządzeniem.

PROMILER Sp. z o.o.

ul. Głogowska 277, 60-104 Poznań, tel. 609 444 454




Ekran dotykowy oferuje intuicyjną interakcję użytkownika i urządzenia. Analizator można postawić na wąskiej części tylnej, co pozwala ograniczyć zajmowaną przestrzeń do minimum. W takiej pozycji wyświetlacz obrócić można o 180°.



Przłącza jednostki Alcotest 9510 (USB, RS 232, Ethernet, itp.) umożliwiają integrację urządzenia z kompleksowymi sieciami danych, włącznie ze zdalną obsługą. W urządzenie wbudowana jest niezawodna drukarka termiczna niewymagająca tonerów ani wkładów z tuszem. Do urządzenia podpiąć można również klawiaturę USB w celu łatwiejszego wprowadzenia danych.

Zestaw

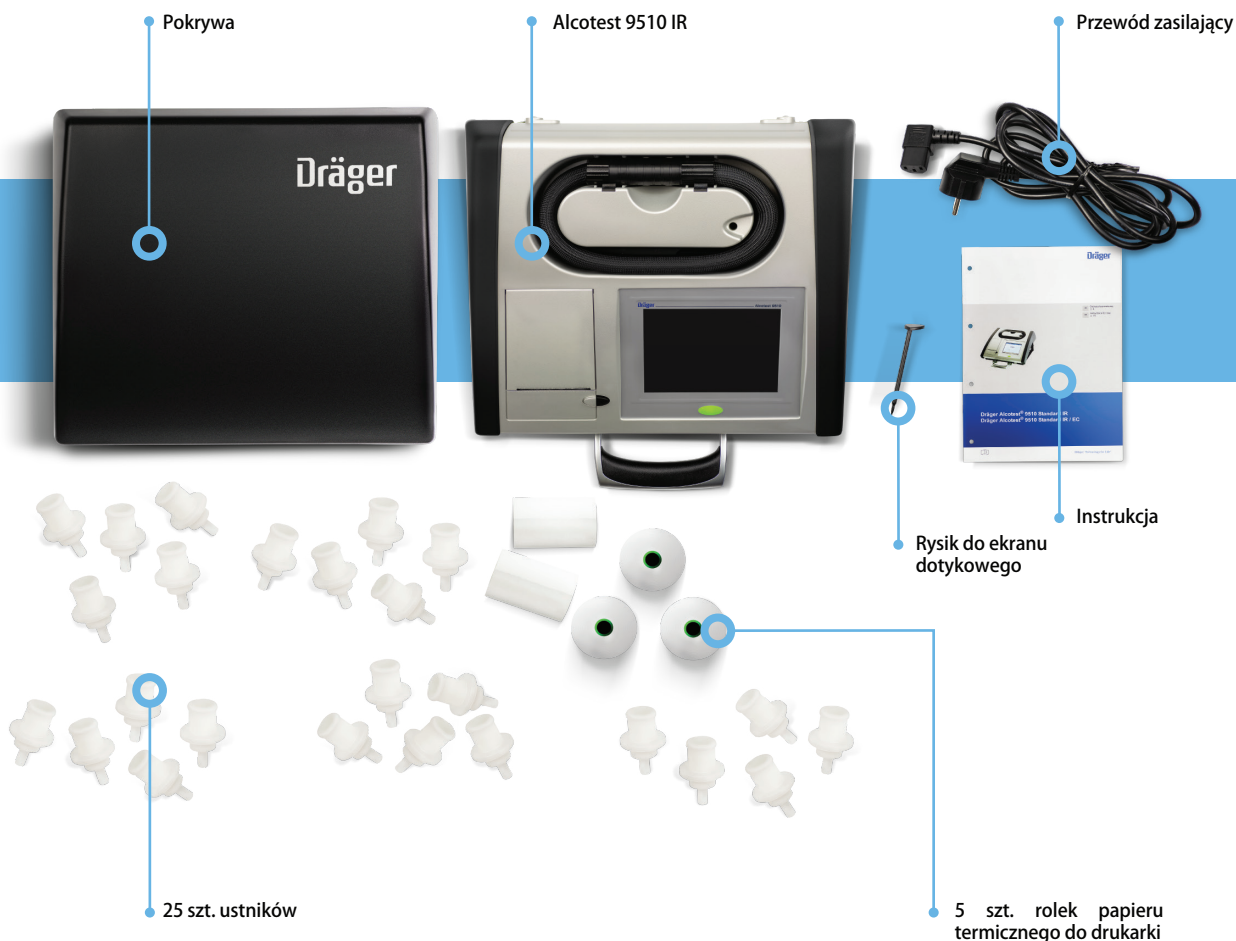

Specyfikacja techniczna



Rodzaj sensora:
podczerwony (9510 IR)
podczerwony / elektrochemiczny (9510 IR / EC)



Precyzja pomiaru:
0,007 mg/l przy 0,4 mg/l



Zakres wilgotności (środowisko pracy)
10 do 95 % wilgotności względnej, nie skondensowanej



Temperatura pracy
0°C do 40°C



Dotykowy ekran
Full HD, ekran 5,8 cali



Kalibracja
co 6 miesięcy



Temperatura przechowywania
- 20°C do 70°C



Czas pomiaru
ok. 5 s.



Pamięć
500 zestawów danych
z wynikami testu



System operacyjny
Windows CE

0,00 mg/l


3,00 mg/l

ZAKRES POMIARU



waga

7kg

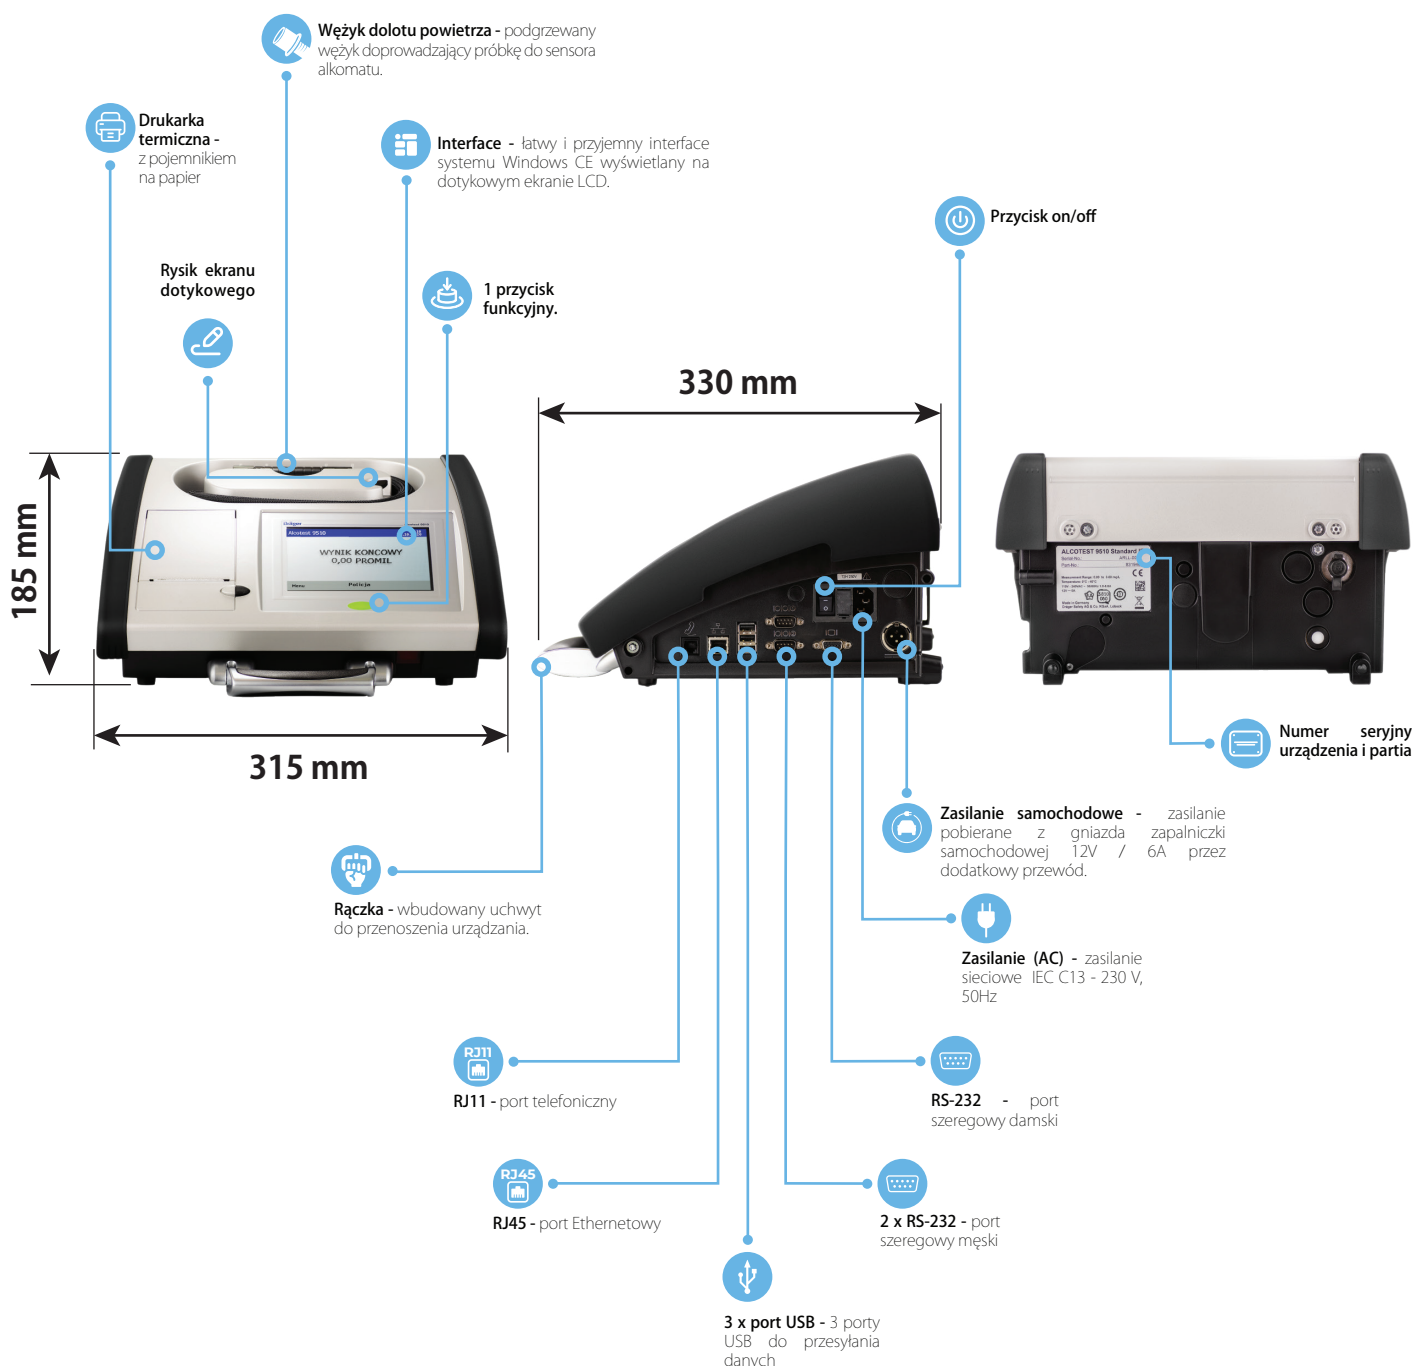

Akcesoria do alkomatu 9510



Walizka na urządzenie Dräger Alcotest® 9510

Do bezpiecznego transportu i wysyłki analizatora Dräger Alcotest® 9510, np. w celu przeprowadzenia kalibracji okresowych. Mieści papier do drukarki, ustniki, klawiaturę i przewód zasilający.



Torba na urządzenie Dräger Alcotest® 9510

Idealna do noszenia analizatora Alcotest® 9510. Dodatkowa kieszeń mieści akcesoria takie jak klawiatura, ustniki, przewód zasilający i papier do drukarki.



Ustniki

Ustniki w wersji „Classic” z zaworkiem zwrotnym lub bez niego, pakowane oddzielnie w celu zapewnienia higienicznego kontaktu osoby badanej z urządzeniem. Dostępne również w wersji niebieskiej do urządzeń z funkcją pomiaru temperatury oddechu.



Klawiatura (USB)

Kompaktowa klawiatura USB do wprowadzania danych. Dostępna w układzie QWERTY, QWERTZ lub AZERTY.



Papier do drukarek termicznych

Rolki papieru do drukarki w opakowaniach po 5 szt. Wydruki mogą być przechowywane przez okres nawet 25 lat.



Kabel samochodowy 12 V DC

Do gniazda prądu stałego w samochodzie (2 m). Wyposażony we włącznik/wyłącznik.